

TRIOS meets Prime

powered by DS Core
and 3Shape Unite



3Shape TRIOS scanner ユーザー様、朗報です。 TRIOS scanner で院内内製へ


デンツプライシロナのミリング/3Dプリンターとの連携により、院内内製へと拡張。
DS Coreと3Shape Uniteとの連携によりTRIOSスキャナーとPrimemillまたは
Primeprintをシームレスに接続。
デンツプライシロナの35年以上にわたる卓越した院内内製の臨床技術を是非ご活用ください。

4ステップのシームレスなワークフロー



スキャン

患者データを
メディアライブラリーに保存し
トリオスでスキャンします。



送る

フルカラーでのスキャンデータ
および患者情報を転送し
DS Coreへシームレスに
アップロード



設計

DS のinLabソフトウェアへの
統合されたアクセスにより、
迅速で簡単な設計



製造

院内で内製:
• Primemillおよび
SpeedFireで最終補綴物を作製
• PrimePrintソリューションで
リムーバルおよびテンポラリー
アプリケーションを作製

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1
住友不動産汐留濱離宮ビル
www.dentsplysirona.com

販売元

株式会社モリタ

東京本社：〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
Tel:03-3834-6161 Fax:03-3834-6177
大阪本社：〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
Tel:06-6380-2525 Fax:06-6380-2106
http://www.dental-plaza.com

 Dentsply
Sirona

TRIOSスキャナーをPrimemillまたはPrimeprintと接続した 院内製で得られる多くのメリット

拡張

- 即日修復やアプライアンスアプリケーションに対応し新しいワークフローで診療を拡張し、患者満足度を向上させます。
- 診療の効率性と拡張性で歯科医院を新たなステージへ導きます。


効率性

- inLabソフトウェアにより直感的な操作で修復物を設計、設計後は接続されたPrimemillおよびSpeedFireでシームレスに加工します。
- DS Coreでいつでもどこでも患者様のカルテにリモートアクセス、時間を節約し医院の活性化に役立ちます。

優位性

- 検証された1ワークフローにより、多くのマテリアルであらゆる治療に対応します。
- 高いクウォリティのクラウンや再現性の高いスプリント等の即日修復も実現します。

1. Reiss B. Compend Contin Educ Dent. 2001;22(6 Suppl):14-18. Reiss B. Int J Comput Dent. 2006;9(1):11-22. Otto T. Int J Comput Dent. 2017;20(3):315-329. Abdulrahman S, et al. BMC Oral Health. 2021;21(1):625.

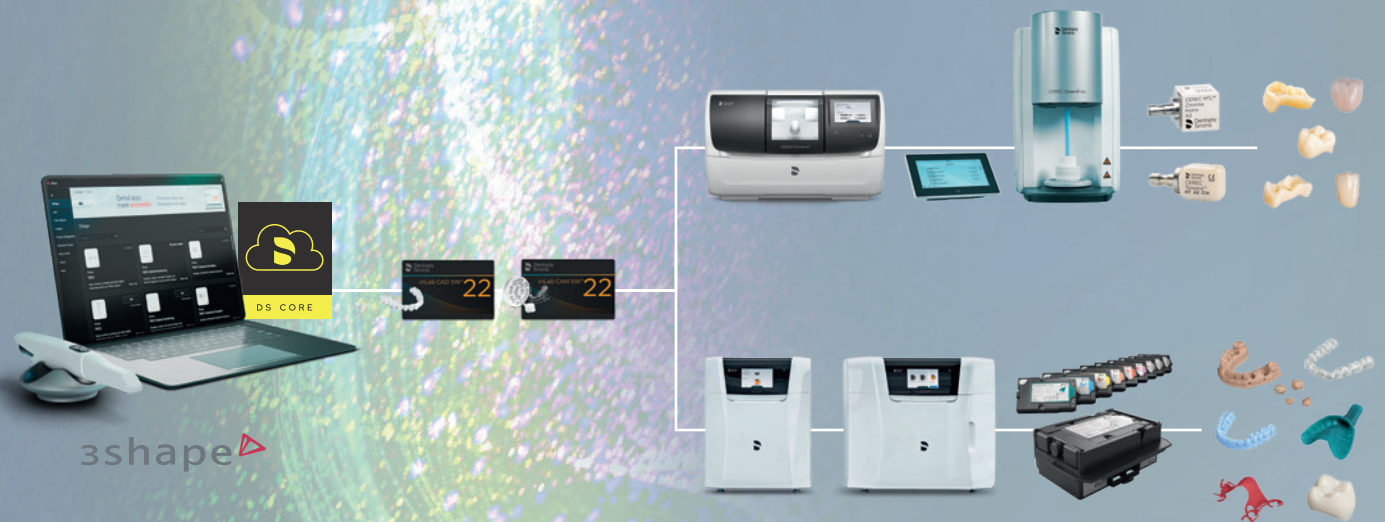

一般の名称: デジタル印象採得装置 販売名: TRIOS 5 オールインワンシステム 承認番号: 30500BZ100031000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
 一般の名称: 歯科技工用ボイスアシスト装置 販売名: セレック スピードファイア 届出番号: 13B1X10236S10009 一般医療機器
 一般の名称: 歯科技工用設計ソフトウェア支援設計・製造ユニット 販売名: セレック プライムミル 届出番号: 13B1X10236S10022 一般医療機器
 一般の名称: 歯科切削加工用セラミックス 販売名: セレック ブロック 承認番号: 220AABZ100045000 管理医療機器
 一般の名称: 歯科切削加工用セラミックス 販売名: セレック テセラ 承認番号: 303AGBZX00018000 管理医療機器
 一般の名称: 歯科切削加工用セラミックス 販売名: セレック シルニエア 承認番号: 303AGBZX00048000 管理医療機器
 一般の名称: 歯科切削加工用セラミックス 販売名: セレック MTL シルニエア 承認番号: 304AGBZ100007000 管理医療機器
 一般の名称: 歯科技工用装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名: プライムプリント 届出番号: 13B1X10236S10023 一般医療機器
 一般の名称: 歯科技工用重巻装置 販売名: プライムプリント PPU 届出番号: 13B1X10236S10024 一般医療機器
 一般の名称: 歯科印象トレー用レジジン 販売名: プライムプリント ガイド 届出番号: 13B1X10236S10026 一般医療機器
 一般の名称: 歯科印象トレー用レジジン 販売名: プライムプリント キャスト 届出番号: 13B1X10236S10025 一般医療機器
 一般の名称: 歯科咬合スプリント用材料 販売名: プライムプリント スプリント 届出番号: 13B1X10236S10027 一般医療機器
 一般の名称: 歯科印象トレー用レジジン 販売名: プライムプリント トレー 届出番号: 13B1X10236S10028 一般医療機器
 一般の名称: 歯科用樹脂系模型材 販売名: プライムプリント モデル 届出番号: 13B1X10236S10029 一般医療機器
 一般の名称: 歯科用樹脂系模型材 販売名: プライムプリント モデルT 届出番号: 13B1X10236S10030 一般医療機器
 一般の名称: 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ 販売名: プライムプリント テンプ 承認番号: 305AGBZX00004000 管理医療機器